myLoop
powered by CamAPS | FX

CamAPS FX appen på iPhone

Spesifikk informasjon og instruksjoner om iOS

Systemet for automatisert insulintilførsel (AID) myLoop består av CamAPS FX appen, YpsoPump insulinpumpen og FreeStyle Libre 3 Plus eller Dexcom G7 glukosemålersensor **er nå tilgjengelig for iPhone!**

Slik laster du ned iOS-versjonen av CamAPS FX appen

Last ned CamAPS FX appen (mmol/L) fra Apple App Store på iPhonen din. Bruk QR-koden for å laste ned appen direkte. Det er anbefalt å deaktivere automatiske oppdateringer i innstillingene for App Store for å sikre at CamAPS FX appen fungerer som den skal til enhver tid.

mmol/L

Merknad om kompatibilitet

Før du laster ned CamAPS FX appen må du kontrollere om operativsystemet på smarttelefonen din er kompatibel med appen.

- CamAPS FX appens minstekrav til operativsystemet er oppgitt her: https://camdiab.com/nb/faq
- Smarttelefoner som er kompatible med FreeStyle Libre 3 Plus sensor: www.diabetescare.abbott/support/manuals/no.html (les dokumentet "Mobile Device & OS Compatibility" (Kompatibilitet mellom mobil enhet og OS)).
  - Hvis du bruker en FreeStyle Libre 3 Plus sensor, må du passe på at du har en smarttelefon med NFC (near field communication).
- Smarttelefoner som er kompatible med Dexcom G7 glukosemålersystemet: www.dexcom.com/nb-NO/compatibility/g7.

Bytte mellom Android og iOS

Hvis du vil bytte fra Android-versjonen av CamAPS FX appen til iOS-versjonen (eller motsatt), må du tenke på det følgende.

Planlegg byttet nøye

Planlegg byttet nøye for å sikre at all viktig informasjon er lagret, overgangen er så problemfri som mulig og at behandlingen din ikke blir avbrutt. Det anbefales at du utfører byttet sammen med diabetesteamet ditt. Hvis du har noen spørsmål eller trenger hjelp, kan du ta kontakt med din lokale kundeservice.

Sikkerhetskopier dataene dine

For å unngå å miste noen data bør du lage og lagre en PDF-rapport av datahistorikken din før du bytter mellom Android- og iOS-appen. Dette kommer til å hjelpe deg og diabetesteamet med å opprettholde en god oversikt over innstillingene dine som boluskalkulatorinnstillinger, total daglig dose og personlig glukosemål. Bruk PDF-rapporten du lagde, til å fullføre oppsettet av CamAPS FX appen på den nye smarttelefonen din.

Lære opp algoritmen på nytt

Du kan logge deg inn med den samme CamAPS FX kontoen for iPhone og Android smarttelefoner. CamAPS FX algoritmen er nødt til å lære seg de personlige insulinbehovene og -mønstrene i dataene dine på nytt når du bytter mellom Android og iOS. Det kan ta noen dager før insulintilførselen er helt tilpasset behovene dine.

Slett YpsoPump senderen i Bluetooth®-innstillingene på Android-smarttelefonen din før du konfigurerer CamAPS FX appen på iPhone (eller motsatt). Slett CamAPS FX appen fra den gamle smarttelefonen din.

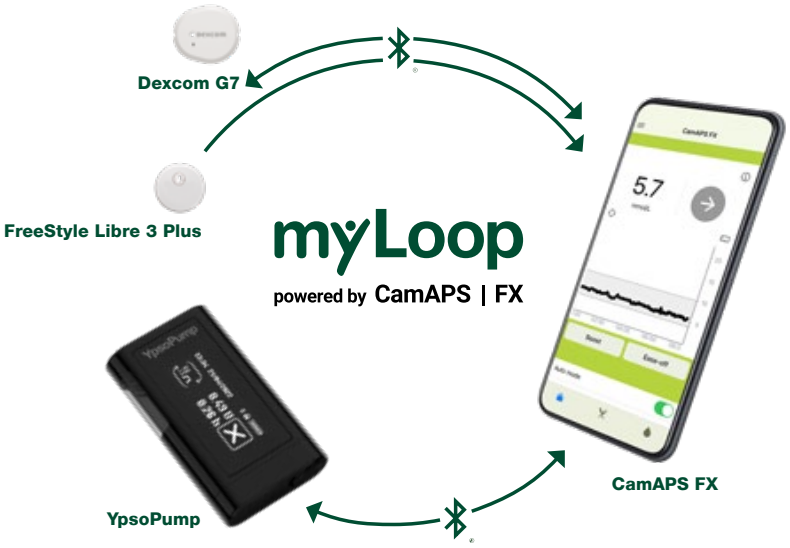

Varselsinnstillinger

- Tidskritiske varsler: må være slått PÅ for å sikre at du mottar varsler fra CamAPS FX appen: Innstillinger ➜ Varsler ➜ CamAPS FX ➜ Tidskritiske varsler
- Lydløs modus: Når du bruker sideknappen, blir ALLE varsler dempet, inkludert Kritisk lav.
- Fokusmodus / Ikke forstyrr: demper ALLE varsler inkludert Kritisk lav med mindre du gjør unntak for CamAPS FX appen.
- Hvis du ikke har lagt inn noen personlige varselsinnstillinger, bruker appen automatisk standardverdier for alle varsler og det personlige glukosemålet.

App-oppdateringer

- Automatiske iOS- og appoppdateringer: Dette kan forhindre at appen fungerer inntil iPhone låses opp og/eller appen gjenåpnes.
- Slå av automatiske iOS-oppdateringer: Innstillinger ➜ Generelt ➜ Oppdatering ➜ Oppdater automatisk
- Slå av automatisk oppdatering av apper: Innstillinger ➜ Apper ➜ App Store ➜ Appoppdateringer
  Merk: Dette deaktiverer automatiske oppdateringer for alle apper, ikke bare for CamAPS FX.
- Brukerkontroll: Brukere mottar varsel før oppdateringer utgis slik at man kan velge når appen skal oppdateres.

Startskjerm
iPhone

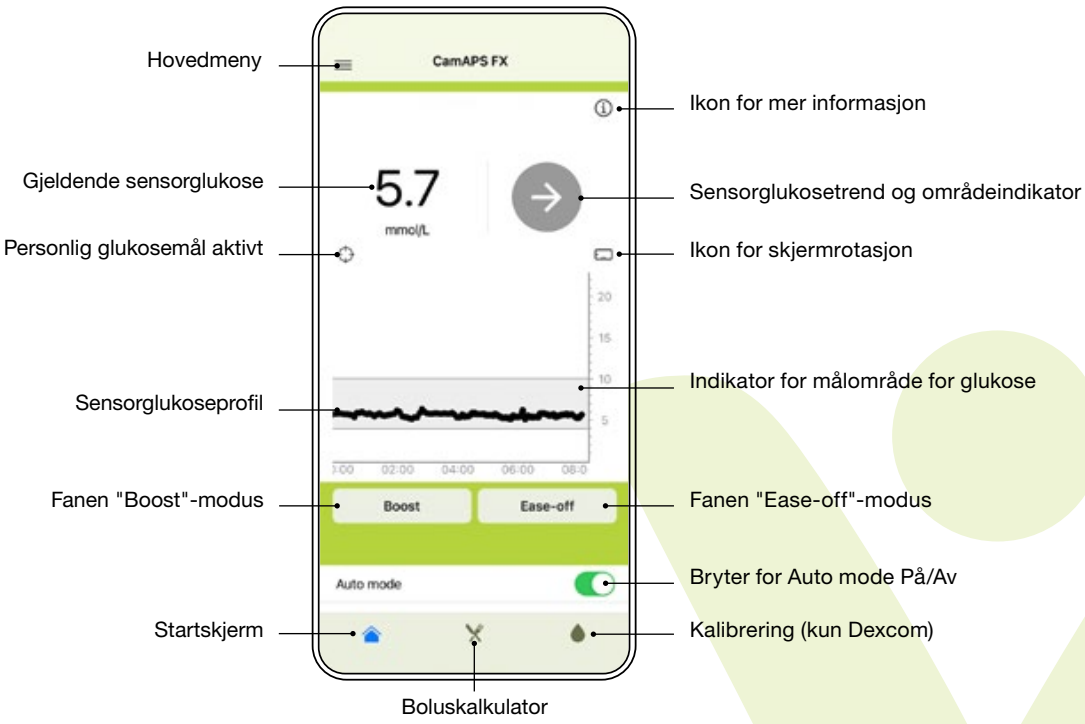

Ansvarsforhold: Produktbildene er kun ment som illustrasjoner. // mylife, myLoop og YpsoPump er et registrert varemerke for mylife Diabetes Care AG eller for dets tilknyttede selskaper. // CamAPS er et registrert varemerke for CamDiab Ltd. // Dexcom og Dexcom G7 er registrerte varemerker for Dexcom, Inc. i USA og/eller andre land. // Sensorenheten, FreeStyle, Libre og relaterte merkevarer tilhører Abbott og anvendes med tillatelse. // iPhone og Apple er varemerker for Apple Inc., og er registrert i USA og i andre land og områder. // Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte varemerker for Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av mylife Diabetes Care AG eller for dets tilknyttede selskaper er under lisens. // Andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Produktbildene er kun til illustrasjonsformål.

For sikkerhetsinformasjon om de nevnte produkter, se mylife-diabetescare.no/sikkerhet

10439655-NO-no/V05

mylife DiabetesCare

mylife Diabetes Care AS
Lysaker Torg 5, 3 etg. • 1366 Lysaker
www.mylife-diabetescare.no